BIKEN

Ｎｏ．B26－002
2026年 10月

検査内容変更のお知らせ

謹啓
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、下記項目につきまして、検査内容の変更がございますので、ご案内申し上げます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

- **抗核抗体**
- **抗ds-DNA-IgG抗体**
- **抗ss-DNA-IgG抗体**
- **抗RNP抗体**
- **抗Sm抗体**
- **抗Scl-70抗体**
- **抗SS-A/Ro抗体**
- **抗SS-B/La抗体**
- **抗糸球体基底膜抗体（抗GBM抗体）**


変更日：2026年9月30日ご依頼分より

一般財団法人 阪大微生物病研究会
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘3番1号

臨床検査に関するお問い合わせ
バイオメディカルサイエンスセンター
TEL：06-6877-4801　FAX：06-6875-5459

●抗核抗体

	新	従来
検査項目名	抗核抗体	同左
検査材料	血清	同左
検体必要量	0.3mL	同左
容器	2	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	3～4	3～5
検査方法	CLEIA法	蛍光抗体法
基準値	10.0未満 (Index)	40倍　未満
単位	なし	倍
報告桁数	小数第1位	整数

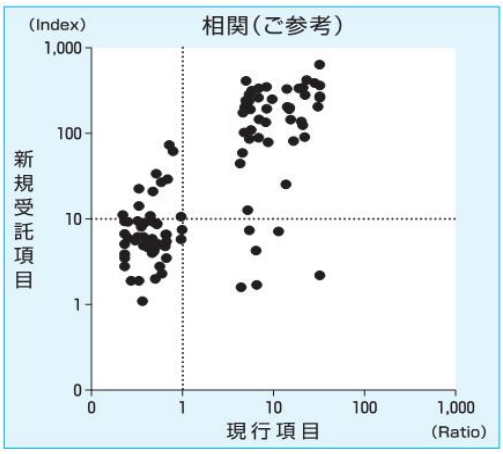


判定一致率		現　行		
		＋	－	合計
新規	＋	44	11	55
	－	6	39	45
	合計	50	50	100

陽性一致率：88.0%
陰性一致率：78.0%
判定一致率：83.0%

(株)BML検討資料

●抗ds-DNA-IgG抗体

	新	従来
検査項目名	抗ds-DNA-IgG抗体	同左
検査材料	血清	同左
検体必要量	0.3mL	同左
容器	2	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	3～4	同左
検査方法	CLEIA法	FEIA法
基準値	12.0以下	(－) 10.0未満 (±) 10.0以上15.0以下 (＋) 15.0を超える
単位	IU/mL	U/mL
報告桁数	小数第1位	同左

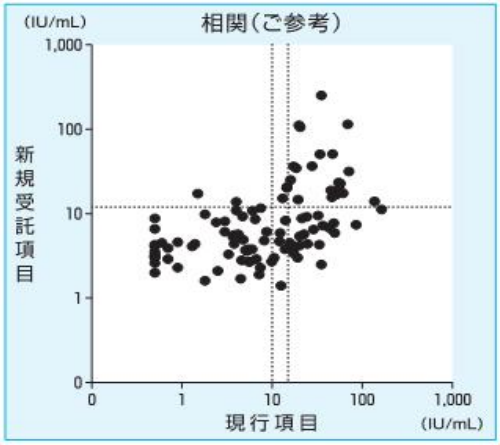

判定一致率		現　行			
		＋	±	－	合計
新規	＋	20	3	2	25
	－	21	6	48	75
	合計	41	9	50	100


陽性一致率：46.0%
陰性一致率：96.0%
判定一致率：71.0%

(株)BML検討資料

※一致率(%)は従来法の(±)を(＋)に含めております。

●抗ss-DNA-IgG抗体

	新	従来
検査項目名	抗ss-DNA-IgG抗体	同左
検査材料	血清	同左
検体必要量	0.3mL	同左
容器	2	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	3～4	同左
検査方法	CLEIA法	FEIA法
基準値	25.0以下	（－）7.0未満 （±） 7.0以上10.0以下 （＋）10.0を超える
単位	AU/mL	U/mL
報告桁数	小数第1位	同左

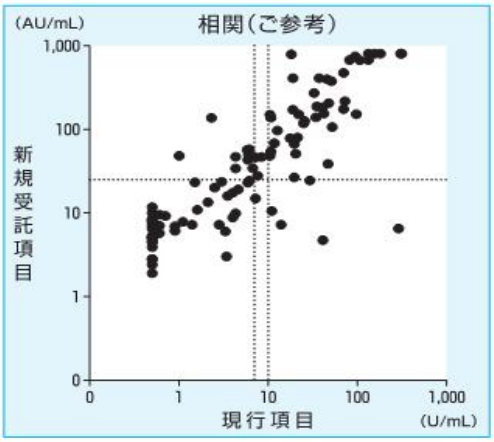

判定一致率		現行			
		＋	±	－	合計
新規	＋	41	3	9	53
	－	5	1	41	47
	合計	46	4	50	100


陽性一致率：88.0%
陰性一致率：82.0%
判定一致率：85.0%

※一致率(%)は従来法の(±)を(＋)に含めております。

(株)BML検討資料

●抗RNP抗体

	新	従来
検査項目名	抗RNP抗体	同左
検査材料	血清	同左
検体必要量	0.3mL	同左
容器	2	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	3～4	同左
検査方法	CLEIA法	FEIA法
基準値	10.0未満	（－）3.5未満 （±） 3.5以上5.0以下 （＋）5.0を超える
単位	U/mL	U/mL
報告桁数	小数第1位	同左

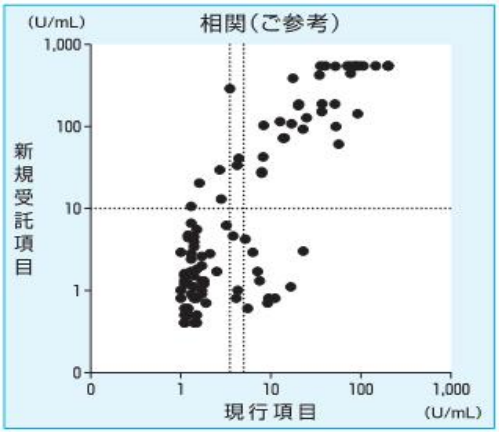

判定一致率		現行			
		＋	±	－	合計
新規	＋	34	3	4	41
	－	10	3	46	59
	合計	44	6	50	100


陽性一致率：74.0%
陰性一致率：92.0%
判定一致率：83.0%

※一致率(%)は従来法の(±)を(＋)に含めております。

(株)BML検討資料

●抗Sm抗体

	新	従来
検査項目名	抗Sm抗体	同左
検査材料	血清	同左
検体必要量	0.3mL	同左
容器	2	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	3～4	同左
検査方法	CLEIA法	FEIA法
基準値	10.0未満	（－）7.0未満 （±） 7.0以上10.0以下 （＋）10.0を超える
単位	U/mL	同左
報告桁数	小数第1位	同左

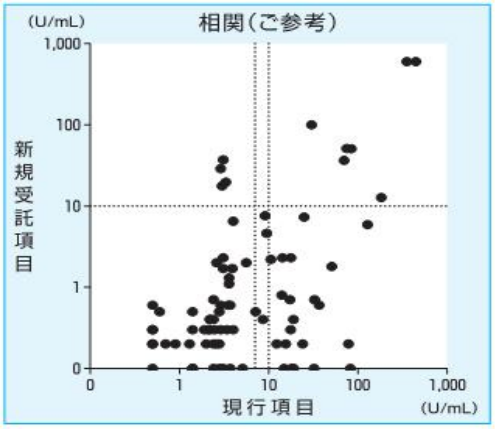

判定一致率		現行			
		＋	±	－	合計
新規	＋	7	0	4	11
	－	21	4	46	71
	合計	28	4	50	82


※一致率（%）は従来法の（±）を（＋）に含めております。

陽性一致率：21.9%
陰性一致率：92.0%
判定一致率：64.6%

(株)BML検討資料

●抗Scl-70抗体

	新	従来
検査項目名	抗Scl-70抗体	同左
検査材料	血清	同左
検体必要量	0.3mL	同左
容器	2	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	3～4	同左
検査方法	CLEIA法	FEIA法
基準値	10.0未満	（－）7.0未満 （±） 7.0以上10.0以下 （＋）10.0を超える
単位	U/mL	同左
報告桁数	小数第1位	同左

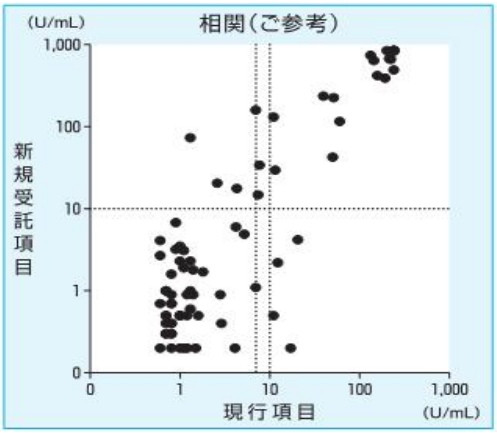

判定一致率		現行			
		＋	±	－	合計
新規	＋	20	3	3	26
	－	4	1	47	52
	合計	24	4	50	78


※一致率（%）は従来法の（±）を（＋）に含めております。

陽性一致率：82.1%
陰性一致率：94.0%
判定一致率：89.7%

(株)BML検討資料

●抗SS-A/Ro抗体

	新	従来
検査項目名	抗SS-A/Ro抗体	同左
検査材料	血清	同左
検体必要量	0.3mL	同左
容器	2	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	3～4	同左
検査方法	CLEIA法	FEIA法
基準値	10.0未満	(－) 7.0未満 (±) 7.0以上10.0以下 (＋) 10.0を超える
単位	U/mL	同左
報告桁数	小数第1位	同左

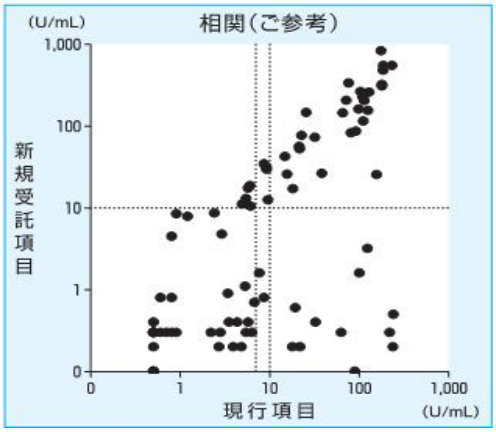

判定一致率		現行			
		＋	±	－	合計
新規	＋	33	4	5	42
	－	11	2	34	47
	合計	44	6	39	89


陽性一致率：74.0%
陰性一致率：87.2%
判定一致率：79.8%

(株)BML検討資料

※一致率(%)は従来法の(±)を(＋)に含めております。

●抗SS-B/La抗体

	新	従来
検査項目名	抗SS-B/La抗体	同左
検査材料	血清	同左
検体必要量	0.3mL	同左
容器	2	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	3～4	同左
検査方法	CLEIA法	FEIA法
基準値	10.0未満	(－) 7.0未満 (±) 7.0以上10.0以下 (＋) 10.0を超える
単位	U/mL	同左
報告桁数	小数第1位	同左

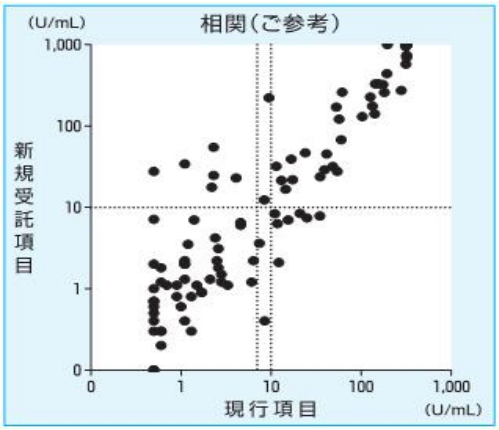

判定一致率		現行			
		＋	±	－	合計
新規	＋	39	2	6	47
	－	7	2	44	53
	合計	46	4	50	100


陽性一致率：82.0%
陰性一致率：88.0%
判定一致率：85.0%

(株)BML検討資料

※一致率(%)は従来法の(±)を(＋)に含めております。

●抗糸球体基底膜抗体（抗GBM抗体）

	新	従来
検査項目名	抗糸球体基底膜抗体 （抗GBM抗体）	同左
検査材料	血清	同左
検体必要量	0.3mL	同左
容器	2	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	3～4	同左
検査方法	CLEIA法	FEIA法
基準値	3.0未満	（－）7.0未満 （±）7.0以上10.0以下 （＋）10.0を超える
単位	U/mL	同左
報告桁数	小数第1位	同左

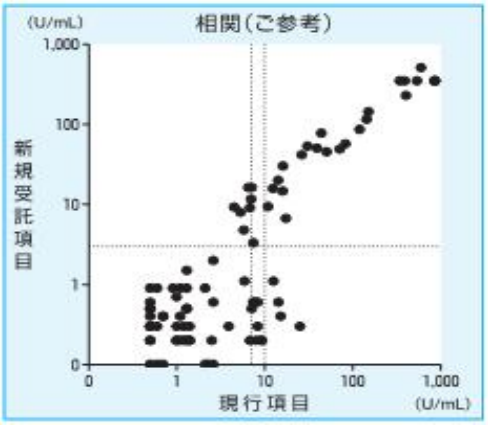

判定一致率		現行			
		＋	±	－	合計
新規	＋	25	3	5	33
	－	4	8	45	57
	合計	29	11	50	90

※一致率(%)は従来法の(±)を(＋)に含めております。

陽性一致率：70.0%
陰性一致率：90.0%
判定一致率：81.1%

(株)BML検討資料